

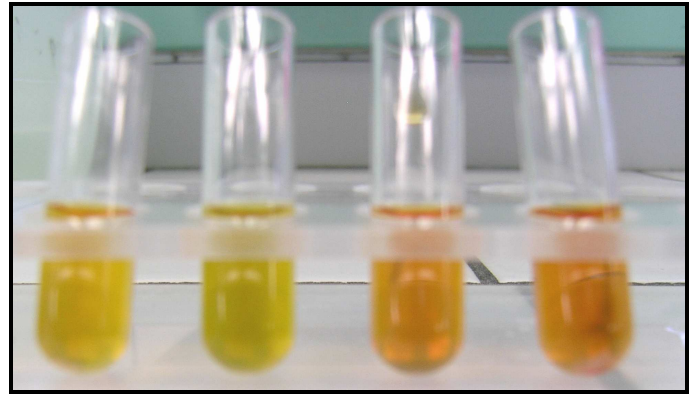



Acceptabilité des sérums réceptionnés

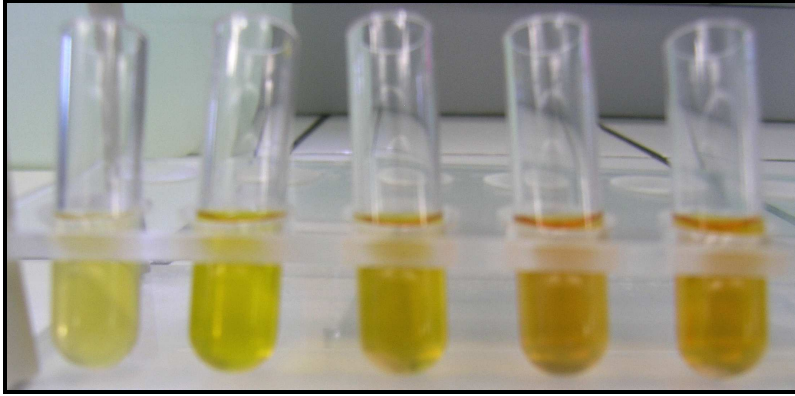


Satisfaisant : Sérum translucide de couleur normale (jaune à rosé)

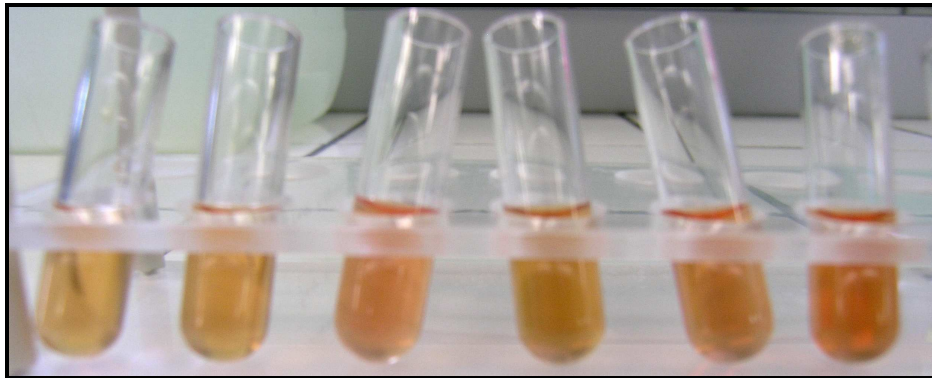

Satisfaisant : Sérum translucide de couleur normale (rosé)

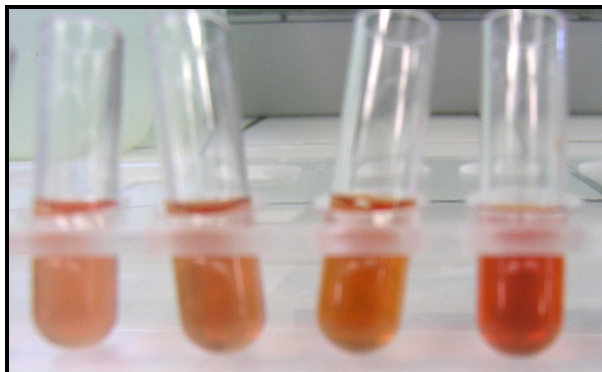

Acceptable : Sérum translucide rosé à rouge

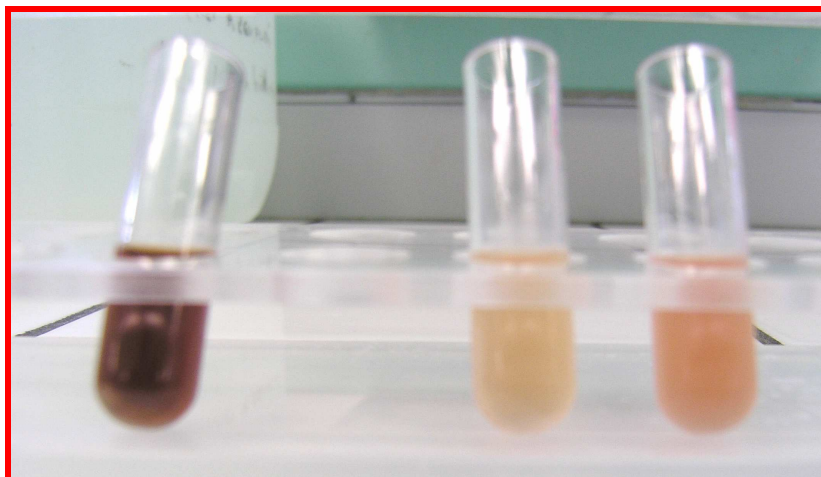

Non satisfaisant : Sérum hémolysé (rouge foncé) ou contaminé (opaque)